COOL-VIEW

# LED PORTABLE STAND LIGHT 2100

**クールビュー**
**LEDポータブルスタンドライト2100**

# 取扱説明書


警告･禁忌･禁止……2
製品と各部位の名称について……3
内容……3
組立方法……4
LEDライト光束、絞りについて……5
バッテリー（蓄電池）の取扱いについて……5
バッテリーパックの使用方法……6
充電器の使用方法……6
お手入れ方法……7
品目仕様……7



【製造販売業者】

T Company

**株式会社ティーカンパニー**

大阪府大阪市淀川区西中島4-6-19　木川ビル1F

TEL：06-6304-6955

第三種医療機器製造販売業許可　27B3X00263


## 保証について

**クールビュー製品のLEDライト部分は3年間保障**

ご購入いただいたクールビュー LEDポータブルスタンドライト２１００が、お買い上げから3年以内にLEDライトの不具合が原因で製品が正常に作動しなくなったり、故障をした場合は、在庫状況に応じて、直ちに新しい製品と交換いたします。

**バッテリー、バッテリー充電器、ACアダプターなどの付属品については1年間保証**

取扱い説明書、注意書などに従った正常な仕様状態でお買い上げより1年以内に故障した場合は、無償で修理交換いたします。無償機関内でも次の場合は有償修理交換となります。

＊使用上の誤り及び埠頭な改造による故障及び破損
＊お買い上げ後の落下などによる故障及び破損
＊火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や電源の以上、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び破損
＊故障の原因が本製品以外に起因する場合。

尚、1年間で300回以上充電をしたバッテリーについても1年間保障の対象外となります。

## 各部位の名称

## 内　容

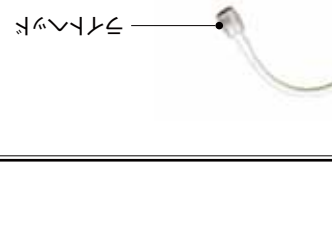



## 【警告】

・本製品の使用前に、この添付文書および取扱説明書のすべてを熟読してください。

・本品は、医師および医師の指示を受けた専門の医療従事者のみが使用ください。

・本製品を水や液体に浸さないでください。水漏れが生じた場合は直ちに電源ユイッチを切り、本商品の装着を外し、乾燥した布なので十分にふき取ってください。

・内部に水などの浸入の恐れがある場合は点検を受け、安全が確認されるまで使用しないでください。

・本製品を使用中、また使用直後はバッテリー周辺部が高温になる場合がありますので、皮膚が直接触れないように、十分にご注意ください。

・光源部分周辺は使用により高温になる場合があります。やけどを引き起こす原因となりますので、ライトの調節などは注意してください。

・本製品の光源を見つめたり、凝視したり、また連続して目を照明したりしないでください。目の組織に障害を引き起こす可能性があります。

・患部組織を診察する場合は光量を最小にしてください。

・皮膚患部への診察に使用の際は照射時間を最小限にしてください。

・皮膚損傷のある場合や麻酔の使用により皮膚感度が変化している場合は特にご注意ください。

## 【禁忌・禁止】

・本製品は火炎性の力スや麻酔ガスなどのある場所では絶対に使用しないでください。爆発の恐れがあります。

・本製品の分解、改造は絶対に行わないでください。故障の原因となります。

・本製品は高圧蒸気滅菌などの滅菌の処置はできません。故障の原因となります。

## 組立方法

①支柱を立てる。

②底部にビスとワッシャーを取り付ける。

③アーム先端にゴム製の輪とアルミの三角留め具をつける。

④付属の六角レンチを使い使いビスを各所、穴に入れてしっかりと締めて固定する。

⑤アルミの三角とめ具にバッテリーパックを差し込む。

### ご注意ください！

ご使用の際は必ずフレキシブルアームの操作ハンドル部分を持ちながらアームを動かしてください。
無理に曲げると故障、破損の原因になります。



## バッテリーパックの使用方法

バッテリーパックの上部にあるツマミをスライドさせることにより、電源のONとOFFを操作し、さらに明るさも調節できます。

バッテリーの充電状態（チャージ量）はツマミ横のランプの色でご確認いただけます。

緑色・・・・・フルチャージ
黄色・・・・・半分以上チャージ
赤色・・・・・充電量の低下

【注　意】
バッテリー内の電力が下がってくるとヘッドライトの明るさが、通常時の約20%まで低下しますので、早めの充電をお願いいたします。

## 充電器の使用方法





バッテリーをチャージするにはバッテリーの黒いツマミ部分を上にして、充電器にしっかりと挿入してください。充電時間はバッテリー内の残電力にもよりますが、約30分から90分です。ライトの色で充電状態をご確認いただけます。

緑点滅・・・・・充電中
緑点灯・・・・・充電完了
赤点灯・・・・・エラー



## 光束・絞りについて

LEDポータブルスタンドライト2100には調節可能な絞り機能がついています。
焦点を絞るには、ライトヘッド部分にあるレンズカバーの部分をゆっくりと時計まわりと同方向に回します。
また、絞りを広げるには、時計まわりと反対方向にレンズカバーの部分をゆっくり回してください。
50mm～ 120mmでスポット集光調節が可能です。

## バッテリー（蓄電池）の取扱い方法

### バッテリー（蓄電池）の本体への挿入方法

バッテリーは、黒いツマミがある側が下、バッテリーパックに固定される溝はある側が上になっています。
スタンドに付いているバッテリーパックのベルトクリップ部分かの約45度の角度にバッテリーを黒いツマミのある側を上にして置き、スライドさせるように挿入します。
バッテリーの下部の溝がバッテリーパックにしっかりとはまり込むように固定します。
バッテリーを取り外す際は黒いツマミをゆっくりと引き出します。

## お手入れ方法

クールビュー LEDノバライトには、ヘッドセット部分の日ごろのお手入れに使いいただけるクリーニングキットがついています。

綿棒をヘッドライト部分の空気穴や溝に入れながら埃や汚れを取り除きます。
また、ヘッドセット本体の汚れがひどいときは、綿棒に中性洗剤や、石鹸水などを水で薄めたものをつけてご使用ください。
尚、以下のものもご使用いただけます。

Banicide
Cidex, CidexPlus,Cidex7
Metracide
10% Wecodne
10% Bleach
70% Isopropyl Alcohol
Wavecide-01
Mild Soap

高圧滅菌器のご使用は絶対におやめください。故障の原因になります。
ＵＶ滅菌器はご使用いただけます。

## 品目仕様

| | |
|---|---|
| 色温度 | 6500K |
| 照度 | 140000ルクス |
| 照野径 | 5.0cm－12.0cm |
| 電源 | 90－260V. 50－60Hｚ. |
| 総重量 | 約5.0kg（バッテリー装着時） |
| サイズ | 【ライトヘッド部分】直径4.0cm. 長さ5.5cm<br>【フレキシブルアーム部分】長さ63.0cm.直径2.5cm<br>【操作ハンドル部分】長さ34.0cm.直径3.5cm<br>【モバイルスタンド部分】高さ83.0cm. 直径55.0cm　ストッパー2ヶ所<br>【機器全体の高さ】(概寸)　185.0cm |
| バッテリー使用時間 | 約4時間（フル充電時） |
| 充電時間 | 約90分 |
| セット内容 | LEDポータブルスタンドライト（キャスター付）、リチウムイオン電池×１、充電器、ACアダプター、クリーニングキット |

PSEマークCE,FCC 許可
UN/DOT 試験合格（T1-T8）カリフォルニア電気協会許可
RoHS加盟